

_____様 No. _____


日付 20 / /



インプラントカード

公益社団法人 日本口腔インプラント学会推奨 Ver 1.2 20180413

このカードはあなたのお口の中のインプラントに関する重要な情報です。
メンテナンスなどの際に必要ですので、大切に保管してください。

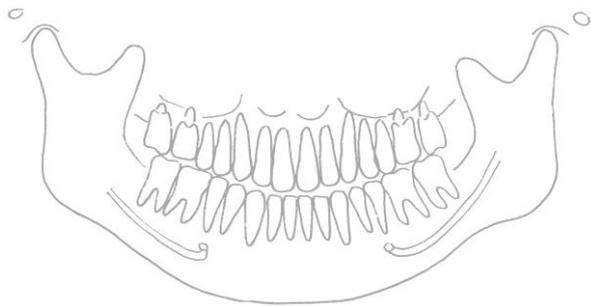

_____様 No. _____


日付 20 / /



インプラントカード

公益社団法人 日本口腔インプラント学会推奨 Ver 1.2 20180413

このカードはあなたのお口の中のインプラントに関する重要な情報です。
メンテナンスなどの際に必要ですので、大切に保管してください。

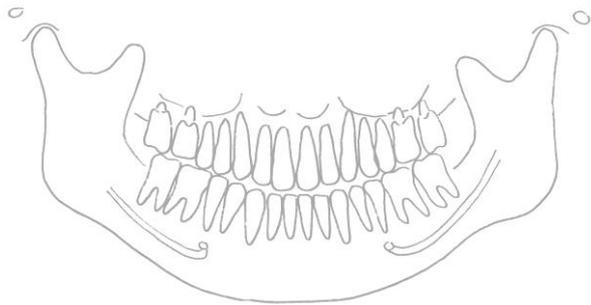

_____様 No. _____


日付 20 / /



インプラントカード

公益社団法人 日本口腔インプラント学会推奨 Ver 1.2 20180413

このカードはあなたのお口の中のインプラントに関する重要な情報です。
メンテナンスなどの際に必要ですので、大切に保管してください。

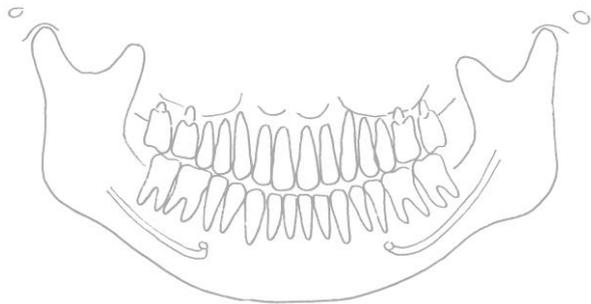

_____様 No. _____


日付 20 / /



インプラントカード

公益社団法人 日本口腔インプラント学会推奨 Ver 1.2 20180413

このカードはあなたのお口の中のインプラントに関する重要な情報です。
メンテナンスなどの際に必要ですので、大切に保管してください。

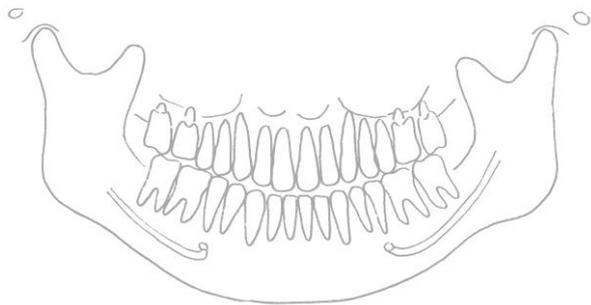

_____様 No. _____

日付 20 / /



インプラントカード

公益社団法人 日本口腔インプラント学会推奨 Ver 1.2 20180413

このカードはあなたのお口の中のインプラントに関する重要な情報です。
メンテナンスなどの際に必要ですので、大切に保管してください。

No	部位	埋入日	装着日	直径／長さ	メーカー名
例	36	2013/9/18	2013/11/19	3.75/10	NOBEL BIOCAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Sc: スクリュー固定screw, FC: セメント固定FinalCement,

インプラント	ドライバー	ロット番号	その他
Mk IV	Unigrip	K10426011	Sc

TC: 仮着TemporaryCement, RD: 可撤義歯RemovableDenture

No	部位	埋入日	装着日	直径／長さ	メーカー名
例	36	2013/9/18	2013/11/19	3.75/10	NOBEL BIOCAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Sc: スクリュー固定screw, FC: セメント固定FinalCement,

インプラント	ドライバー	ロット番号	その他
Mk IV	Unigrip	K10426011	Sc

TC: 仮着TemporaryCement, RD: 可撤義歯RemovableDenture

No	部位	埋入日	装着日	直径／長さ	メーカー名
例	36	2013/9/18	2013/11/19	3.75/10	NOBEL BIOCAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Sc: スクリュー固定screw, FC: セメント固定FinalCement,

インプラント	ドライバー	ロット番号	その他
Mk IV	Unigrip	K10426011	Sc

TC: 仮着TemporaryCement, RD: 可撤義歯RemovableDenture

No	部位	埋入日	装着日	直径／長さ	メーカー名
例	36	2013/9/18	2013/11/19	3.75/10	NOBEL BIOCAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Sc: スクリュー固定screw, FC: セメント固定FinalCement,

インプラント	ドライバー	ロット番号	その他
Mk IV	Unigrip	K10426011	Sc

TC: 仮着TemporaryCement, RD: 可撤義歯RemovableDenture

No	部位	埋入日	装着日	直径／長さ	メーカー名
例	36	2013/9/18	2013/11/19	3.75/10	NOBEL BIOCAR
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Sc: スクリュー固定screw, FC: セメント固定FinalCement,

インプラント	ドライバー	ロット番号	その他
Mk IV	Unigrip	K10426011	Sc

TC: 仮着TemporaryCement, RD: 可撤義歯RemovableDenture